

ENDODONCIA access

DVD
Pasión dental

UNA GAMA DE PRODUCTOS
ECONÓMICOS PARA UNA
ENDODONCIA MÁS RENTABLE.

A partir de

19,95€

GO-TAPER
FLEX



Elige tu instrumento según la dificultad del conducto y el movimiento de preparación.

| TRATAMIENTO | | | | RETRATAMIENTO | | | |
|--|------------------------------------|--|---|---|--|---|--|
| <p>MOVIMIENTO CONTINUO</p> <p>Casos estándar conductos rectos y/o suficientemente anchos</p> | | <p>Casos difíciles conductos finos y/o curvos</p> | | <p>MOVIMIENTO ALTERNO ANTIHORARIO Y HORARIO</p> <p>Casos estándar conductos rectos y/o suficientemente anchos</p> | | <p>MOVIMIENTO CONTINUO</p> <p>GO-TAPER RETRATAMIENTO</p> | |
| <p>Casos difíciles conductos finos y/o curvos</p> | | <p>Casos estándar conductos rectos y/o suficientemente anchos</p> | | <p>Casos difíciles conductos finos y/o curvos</p> | | <p>MOVIMIENTO ALTERNO ANTIHORARIO Y HORARIO</p> <p>REVERSO SILVER</p> | |
| <p>GO-TAPER FLEX</p> <p>GO-TAPER UNIVERSAL</p> <p>GO-TWO</p> | <p>GO-TAPER FLEX</p> <p>GO-TWO</p> | <p>REVERSO SILVER</p> <p>REVERSO BLUE</p> <p>EASY-FILE FLEX</p> | <p>REVERSO BLUE</p> <p>EASY-FILE FLEX</p> | <p>REVERSO SILVER</p> | | | |

Prueba la gama de limas Access sin compromiso


T. 900 300 475 | 687 677 666 | dvd-dental.com

LIMAS DE MOVIMIENTO CONTINUO

PRETRATAMIENTO

Preparan el paso de las limas de preparación de los conductos radiculares (tipo GO-TAPER, REVERSO o EASY-FILE FLEX).

Instrumentos fabricados en níquel-titanio (NiTi), se adaptan a todos los motores de endodoncia y contra-ángulos con rotación continua.

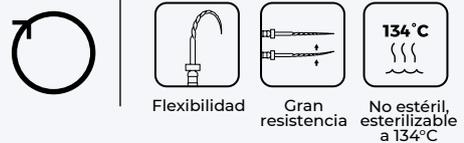

PREFILE

Limas endododónticas mecanizadas para la permeabilización de los conductos.

- Alisa y uniformiza los conductos antes de la preparación.
- Trabaja igual de bien en los conductos finos y curvos.
- Una sola lima necesaria para el cateterismo de todo tipo de conductos.
- Punta roma, respeta la forma de los conductos.
- Velocidad de rotación: 300 rpm.

-42%

35,80€
20,75€



| PREFILE | Longitud | | |
|-------------------------|----------|---------|-----------------------|
| | 21 mm | 25 mm | 31 mm |
| Surtido 2% ISO 13/16/19 | 3137577 | 3137581 | 3137585 |
| 2% ISO 13 | 3137574 | 3137578 | 3137582 |
| 2% ISO 16 | 3137575 | 3137579 | 3137583 |
| 2% ISO 19 | 3137576 | 3137580 | 3137584 |
| Caja de 6 instrumentos | 35,80€ | 31,60€* | x3 24,10€* x5 20,75€* |

*Precio neto sin descuento adicional.

GO-GLIDER

Lima de cateterización endodóntica mecanizada para la permeabilización de conductos.

- Alisa y uniformiza los conductos antes de la preparación.
- Trabaja igual de bien en los conductos finos y curvos.
- Una sola lima necesaria para el cateterismo de todo tipo de conductos.
- Punta roma, respeta la forma de los conductos.
- Velocidad de rotación: 300 rpm.

-38%

39,90€
24,90€




| GO-GLIDER | Longitud | | |
|------------------------|----------|---------|-----------------------|
| | 21 mm | 25 mm | 31 mm |
| 2% - ISO 16 | 3137445 | 3137446 | 3137447 |
| Caja de 6 instrumentos | 39,90€ | 35,65€* | x3 29,00€* x5 24,90€* |

*Precio neto sin descuento adicional.

LIMAS DE MOVIMIENTO CONTINUO

TRATAMIENTO

Secuencia de operación



Flexibilidad

Gran capacidad de corte

Gran resistencia

No estéril, esterilizable a 134°C

GO-TAPER UNIVERSAL

Recupera las sensaciones originales. Secuencia endodóntica de conicidad variable en níquel-titanio (NiTi), para la preparación y limpieza del conducto.

-48%

34,95€
18,15€



| GO-TAPER UNIVERSAL | Longitud | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 19 mm | 21 mm | 25 mm | 31 mm |
| Kit Surtido A0 – B3 | - | 3107604 | 3107612 | 3107620 |
| A0 – 4% – ISO 19 | 3107596 | - | - | - |
| A1 – 2% – ISO 18 | - | 3107597 | 3107605 | 3107613 |
| A2 – 4% – ISO 20 | - | 3107598 | 3107606 | 3107614 |
| B1 – 7% – ISO 20 | - | 3107599 | 3107607 | 3107615 |
| B2 – 8% – ISO 25 | - | 3107600 | 3107608 | 3107616 |
| B3 – 9% – ISO 30 | - | 3107601 | 3107609 | 3107617 |
| B4 – 6% – ISO 40 | - | 3107602 | 3107610 | 3107618 |
| B5 – 5% – ISO 50 | - | 3107603 | 3107611 | 3107619 |

Caja de 6 instrumentos 34,95€ **19,85€*** x3 **18,15€***

*Precio neto sin descuento adicional.

GO-TAPER FLEX

Flexibilidad y resistencia. Secuencia endodóntica de conicidad variable en níquel-titanio (NiTi), para la preparación y limpieza del conducto, con un tratamiento térmico para una mejor flexibilidad de la lima.

-49%

39,08€
19,95€



| GO-TAPER FLEX | Longitud | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 19 mm | 21 mm | 25 mm | 31 mm |
| Kit Surtido | - | 3109587 | 3109595 | 3109603 |
| A0 – 4% – ISO 19 | 3109579 | - | - | - |
| A1 – 2% – ISO 18 | - | 3109580 | 3109588 | 3109596 |
| A2 – 4% – ISO 20 | - | 3109581 | 3109589 | 3109597 |
| B1 – 7% – ISO 20 | - | 3109582 | 3109590 | 3109598 |
| B2 – 8% – ISO 25 | - | 3109583 | 3109591 | 3109599 |
| B3 – 9% – ISO 30 | - | 3109584 | 3109592 | 3109600 |
| B4 – 6% – ISO 40 | - | 3109585 | 3109593 | 3109601 |
| B5 – 5% – ISO 50 | - | 3109586 | 3109594 | 3109602 |


Caja de 6 instrumentos 39,08€ **22,35€*** x3 **19,95€***

*Precio neto sin descuento adicional.

LIMAS DE MOVIMIENTO CONTINUO

TRATAMIENTO

Secuencia de operación

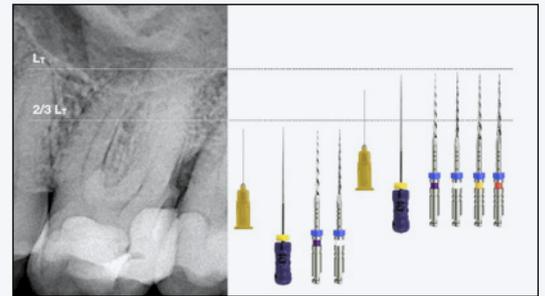

Flexibilidad



Gran capacidad de corte



Gran resistencia



No estéril, esterilizable a 134°C

GO-TWO

Secuencia endodóntica de níquel-titanio (NiTi) de conicidad constante, para la preparación de conductos y el ensanchamiento del corredor de irrigación y la limpieza del canal.

Se adaptan a todos los motores y contraángulos endodónticos de rotación continua.

- Muy buen poder de corte.
- Fuerte conicidad apical que permite una buena limpieza del conducto.
- Evacuación facilitada de los residuos.
- Buena estabilidad gracias a los múltiples bordes.
- Punta roma.
- 1 secuencia fácil para todos los canales.



34,90€
16,60€

-52%

| Longitud de la parte de trabajo: 16 mm | | | | Longitud de la parte de trabajo: 21 mm | | | |
|--|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|
| Conicidad | ISO | 21 mm | 25 mm | Conicidad | ISO | 25 mm | 31 mm |
| Surtido | Nº10-20 | 3137520 | 3137521 | Surtido | Nº10-20 | 3137524 | |
| | Nº25-40 | 3137522 | 3137523 | | | | |
| 4% | Nº10 | 3137525 | 3137526 | 4% | Nº10 | 3137546 | 3137547 |
| | Nº35 | 3137527 | 3137528 | | Nº35 | | 3137548 |
| | Nº40 | 3137529 | 3137530 | | Nº40 | | 3137549 |
| 5% | Nº15 | 3137531 | 3137532 | 5% | Nº15 | 3137550 | 3137551 |
| | Nº30 | 3137533 | 3137534 | | Nº30 | | 3137552 |
| 6% | Nº20 | 3137535 | 3137536 | 6% | Nº20 | 3137553 | 3137554 |
| | Nº25 | 3137537 | 3137538 | | Nº25 | 3137555 | 3137556 |
| | Nº30 | 3137539 | 3137540 | | Nº30 | | 3137557 |
| | Nº35 | 3137541 | 3137542 | | Nº35 | | 3137558 |
| 7% | Nº40 | | 3137543 | 7% | Nº40 | | 3137559 |
| | Nº25 | 3137544 | 3137545 | | | | |

Caja de 6 instrumentos 34,90€ 19,85€* x3 18,15€* x5 16,60€*

*Precio neto sin descuento adicional.

LIMAS DE MOVIMIENTO CONTINUO

RETRATAMIENTO

GO-TAPER RETRATAMIENTO

Para una fácil eliminación del relleno endodóntico. Secuencia endodóntica de conicidad variable en níquel-titanio (NiTi), para la eliminación de la obturación endodóntica. Instrumentos adaptados a cada tercio del conducto radicular.


- Elimina fácilmente el sellado endodóntico.
- Instrumentos eficaces para cada tercio del canal radicular.
- 3 longitudes y 3 conicidades progresivas.
- Identificación fácil gracias a las diferentes ranuras del mango.
- Con punta roma.

| GO-TAPER RETRATAMIENTO | Longitud | Referencia |
|------------------------|----------|----------------|
| Kit Surtido | Surtido | 3107624 |
| C1 - 9% - ISO 30 | 16 mm | 3107621 |
| C2 - 8% - ISO 25 | 18 mm | 3107622 |
| C3 - 7% - ISO 20 | 22 mm | 3107623 |

Caja de 6 instrumentos 34,95€ **19,85€*** x3 **18,15€***

*Precio neto sin descuento adicional.

Secuencia de operación para el retratamiento

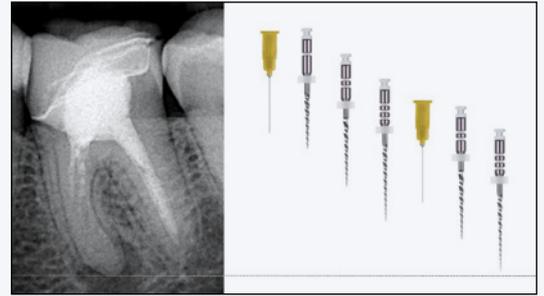

-48%

34,95€
18,15€



BANDEJAS DE INSTRUMENTOS

Bandejas desechables en plástico de color blanco, con compartimientos y superficie texturada. Contenido: 400 bandejas.

- Dimensiones: 28 x 18 cm.
- Material: PET reciclado y biodegradable, aspecto brillante.
- Muy resistentes y ligeras.

-44%

35,90€
19,99€



LIMAS DE MOVIMIENTO ALTERNO

PRETRATAMIENTO

Preparan el paso de las limas de preparación de los conductos radiculares (tipo REVERSO y EASY-FILE FLEX).

Instrumentos fabricados en níquel titanio (NiTi), se adaptan a todos los motores de endodoncia y contra-ángulos con movimiento alterno.



Flexibilidad



Gran resistencia



No estéril, esterilizable a 134°C

EASY-FILE FLEX *Glider*

Limas endodónticas NiTi con tratamiento térmico de cateterismo mecanizadas, para la permeabilización de los conductos.

- Respetar la forma de los canales.
- Bajo riesgo de fractura.
- Simplicidad y rapidez: solo un instrumento para toda la preparación del conducto.
- Alisa y uniformiza los conductos antes de la preparación.
- Trabaja igual de bien en los canales finos y curvos.
- Una sola lima es necesaria para el cateterismo de todo tipo de conductos.
- Repetan la forma de los canales.
- Con punta roma.



| EASY-FILE FLEX GLIDER | Longitud | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 21 mm | 25 mm | 31 mm |
| ISO 15 2% | 3137482 | 3137483 | 3137484 |

Caja de 6 instrumentos 48,25€ 44,00€* x3 33,25€*

*Precio neto sin descuento adicional.

48,25€

33,25€


-31%

Instrumentos adecuados para todos los motores y contra-ángulos endodónticos que trabajan en movimiento alterno antihorario y horario.

LIMAS DE MOVIMIENTO ALTERNO

TRATAMIENTO

Secuencia de operación

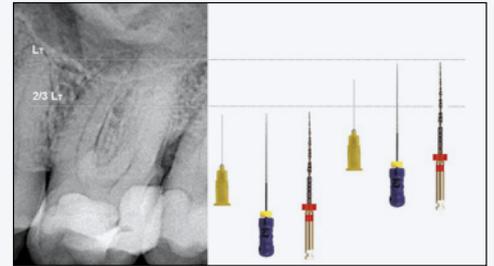

Flexibilidad



Gran capacidad de corte



Gran resistencia




No estéril, esterilizable a 134°C

REVERSO BLUE

Limas de níquel-titanio (NiTi) con tratamiento térmico de conicidad variable, para la preparación del conducto radicular durante el tratamiento endodóntico.

-36%

65,83€
42,45€

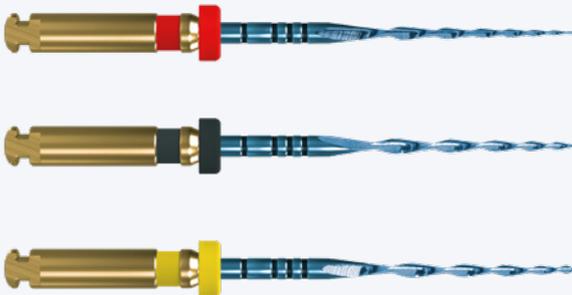

| REVERSO BLUE | Longitud | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 21 mm | 25 mm | 31 mm |
| Kit Surtido | 3121013 | 3121017 | 3121021 |
| SO25 - 8% - ISO 25 | 3121010 | 3121014 | 3121018 |
| SO40 - 6% - ISO 40 | 3121011 | 3121015 | 3121019 |
| SO50 - 5% - ISO 50 | 3121012 | 3121016 | 3121020 |

Caja de 6 instrumentos 65,83€ **47,45€* x3 42,45€***


*Precio neto sin descuento adicional.

EASY-FILE FLEX

Simplificación del protocolo endodóntico ¡Toda la preparación con una lima!
Conicidad variable en níquel-titanio (NiTi), flexibilidad mejorada gracias al tratamiento térmico, para la preparación del conducto radicular durante el tratamiento endodóntico. Trabaja todo lo largo del conducto radicular.

-38%

45,83€
28,25€

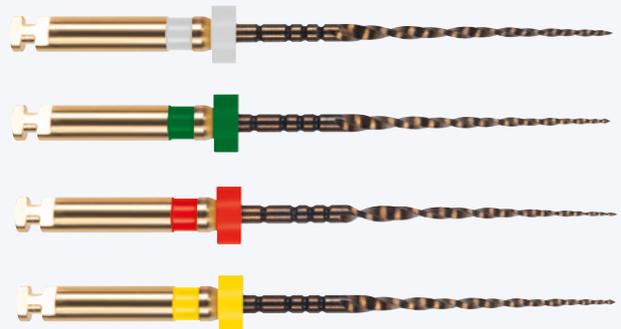

| EASY-FILE FLEX | Longitud | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | 21 mm | 25 mm | 31 mm |
| Kit Surtido. Caja de 4 instrumentos | ● x4 3114838 | 3114843 | 3114848 |
| S20 - 7% - ISO 20 | ● x6 3114834 | 3114839 | 3114844 |
| R25 - 7% - ISO 25 | ● x6 3114835 | 3114840 | 3114845 |
| M35 - 6% - ISO 35 | ● x6 3114836 | 3114841 | 3114846 |
| L45 - 5% - ISO 45 | x6 3114837 | 3114842 | 3114847 |

| | | Oferta x1 | Oferta x3 |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| Kit surtido de 4 instrumentos | 45,83€ | 31,60€* | 28,25€* |
| Reposición de 6 instrumentos | 61,58€ | 43,25€* | 39,10€* |

*Precio neto sin descuento adicional.

LIMAS DE MOVIMIENTO ALTERNO




TRATAMIENTO Y RETRATAMIENTO

Secuencia de operación



Retratamiento

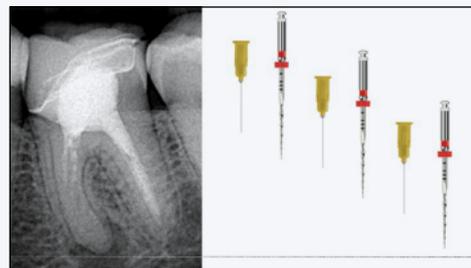

REVERSO SILVER

58,25€
34,90€

Simplificación del protocolo endodóntico.
¡Toda la preparación con una lima!


Limas de níquel-titanio (NiTi) de conicidad variable para el tratamiento y el retratamiento endodónticos. Trabaja todo lo largo del conducto radicular.

-40%

- Funciona también en conductos finos y curvos.
- Evacuación facilitada de los residuos.
- Respeta la forma de los conductos.
- Bajo riesgo de fractura.
- Simplicidad y rapidez: solo un instrumento para toda la preparación del conducto.
- Esterilizable a 134°C.

| REVERSO SILVER | Longitud | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | 21 mm | 25 mm | 31 mm |
| Kit Surtido Caja de 6 instrumentos | 3111539 | 3111543 | 3111547 |
| SO25 - 8% - ISO 25 | 3111536 | 3111540 | 3111544 |
| SO40 - 6% - ISO 40 | 3111537 | 3111541 | 3111545 |
| SO50 - 5% - ISO 50 | 3111538 | 3111542 | 3111546 |
| Caja de 6 instrumentos | 58,25€ 38,25€* x3 | 34,90€* | |

*Precio neto sin descuento adicional.

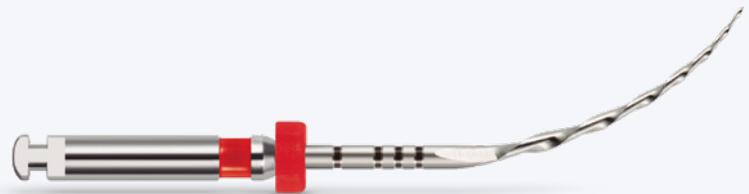

Instrumentos adecuados para todos los motores y contra-ángulos endodónticos que trabajan en movimiento alterno antihorario y horario.

DISCOS ENDOSTOP

Topes preperforados para instrumentos endodónticos. Se utilizan para determinar la longitud de trabajo en el conducto radicular de las limas endodónticas.

- Fácil de instalar en las limas.
- Se adapta a todas las limas.
- Ayuda a localizar el eje cuando el archivo está precurvado, gracias a la marca de marcado.
- Esterilizable a 134°C durante 18 minutos.
- Surtido: 20 discos de cada color.
- Flor: pétalos fácilmente desmontables para calcular el número de usos de las limas y prevenir fracturas por fatiga cíclica de los instrumentos en el conducto radicular.



-49%

4,08€

2,10€

| Estándar | | | | | | | |
|-----------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Colores | Blanco | Amarillo | Rojo | Azul | Negro | Surtido | |
| REF | 3130357 | 3130358 | 3130359 | 3130360 | 3130361 | 3130362 | |
| bolsa de 100 unidades | | | 4,08€ | x1 | 3,20€ | x2 | 2,10€ |

| Flor | | | | | | | |
|-----------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Colores | Blanco | Amarillo | Rojo | Azul | Negro | Surtido | |
| REF | 3130363 | 3130364 | 3130365 | 3130366 | 3130367 | 3130368 | |
| bolsa de 100 unidades | | | 20,75€ | x1 | 14,60€ | x2 | 9,99€ |

GO-TAPER PUNTAS DE PAPEL Y PUNTAS DE GUTTAPERCHA

Puntas destinadas a rellenar y obturar conductos radiculares preparados con instrumentos de conicidad variable.

| | Papel | Gutta |
|----------------------------------|---------|---------|
| Kit Surtido B1-B3 -ISO 20-30 | 3134322 | 3134317 |
| Kit Surtido B4-B5 -ISO 40-50 | 3134321 | 3134316 |
| B1 - ISO 20 | 3134325 | 3134320 |
| B2 - ISO 25 | 3134324 | 3134319 |
| B3 - ISO 30 | 3134323 | 3134318 |
| Caja de 100 puntas de papel | 7,20€ | 5,29€ |
| Caja de 60 puntas de guttapercha | 7,50€ | 5,50€ |



-27%

7,20€

5,29€

Puntas de guttapercha.

- Perfectamente maleables, se ajustan a las paredes del conducto.
- Las puntas permanecen firmes y flexibles.


Puntas de papel.

- Hiperabsorbentes.
- Secado óptimo sin pelusa.
- Las puntas permanecen firmes y flexibles, incluso estando mojadas.

REVERSO PUNTAS DE PAPEL Y PUNTAS DE GUTTAPERCHA

Puntas destinadas a la obturación de los canales radiculares preparados con los instrumentos de tipo REVERSO BLUE y REVERSO SILVER.

| | Papel | Gutta |
|----------------------------------|---------|---------|
| Kit Surtido SO25-SO50 | 3131427 | 3131423 |
| SO25-ISO25 | 3131424 | 3131420 |
| SO40-ISO40 | 3131425 | 3131421 |
| SO50-ISO50 | 3131426 | 3131422 |
| Caja de 100 puntas de papel | 6,84€ | 5,29€ |
| Caja de 60 puntas de guttapercha | 9,00€ | 6,95€ |

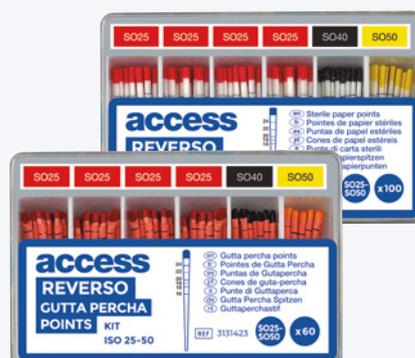

-23%

6,84€

5,29€

Puntas de guttapercha.

- Perfectamente maleables, se ajustan a las paredes del conducto.
- Las puntas permanecen firmes y flexibles.

Puntas de papel.

- Hiperabsorbentes.
- Secado óptimo sin pelusa.
- Las puntas permanecen firmes y flexibles, incluso estando mojadas.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuáles son las recomendaciones para la esterilización con el sistema Access?

Las mismas que para los demás instrumentos de endodoncia. Después de limpiar y eliminar todos los residuos de las limas (si es posible con una ayuda óptica de lupa), sumergir los instrumentos en un baño de ultrasonidos combinado con una solución desinfectante. Es importante respetar los ciclos clásicos recomendados por los fabricantes. Una vez terminado el baño, enjuagar con agua corriente y secar los instrumentos. Embolsarlos y esterilizarlos en un autoclave a 134°C.

¿Cuántas veces se pueden utilizar estos productos?

La limas Access han sido desarrolladas y probadas para soportar 10 usos. Sin embargo, no todos los conductos tienen la misma dificultad, por lo que un uso no es igual a la preparación de un conducto. El sistema propuesto por Access del desgaste de los instrumentos es el siguiente:

- Preparar un conducto relativamente ancho y recto = 1 uso
- Preparar un conducto curvo o calcificado = 2 usos
- Preparar un conducto curvo y calcificado = 3 usos

¿Si no puedo llegar a mi longitud de trabajo con un instrumento, ¿qué debo hacer?


Dependiendo de la dificultad, es normal no poder trabajar todo el conducto en el primer intento. En cualquier caso, no se debe empujar.

- 1 Retirar la lima la lima del conducto, limpiar con rollos de algodón cualquier desecho, enjuagar el conducto con una solución de hipoclorito de sodio y volver a empezar.
- 2 Si la lima Access no avanza, utilizar una lima manual K-File n°10 para comprobar que su permeabilidad sigue presente (es posible que se haya formado un tapón).
- 3 Priorizar siempre secuencias de trabajo pequeñas (no más de 10 segundos en el conducto), para tener siempre un instrumento activo.

¿Qué irrigante debería usar cuando utilizo las limas Access?

Para la preparación mecánica se recomienda utilizar una solución de hipoclorito de sodio de entre el 2 y el 3%.

CASO CLÍNICO DIENTE 47 TRATAMIENTO CON EASY-FILE FLEX

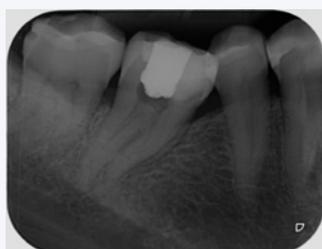

Radiografía preoperatoria



Radiografía de cono maestro



Radiografía postoperatoria



Descubre más casos clínicos

Ajustes del motor según la lima

| CARACT. | ROTACIÓN CONTINUA | | | MOVIMIENTO ALTERNO | | |
|-----------------|-----------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| | GO-TAPER | | | REVERSO | | EASY FILE |
| | GO-TAPER UNIVERSAL | GO-TAPER RETRATAMIENTO | GO-TAPER FLEX | REVERSO SILVER | REVERSO BLUE | EASY FILE FLEX |
| TORQUE | A0, A1 → 5 | 2-5.2 | A2, B1 - 1.5 | / | / | / |
| | A2, B1 → 2 | | A0,A1,B2,B3,- B4,B5 - 3.0 | | | |
| | B2, B3, B4, B5 → 3 | | | | | |
| VELOCIDAD (rpm) | 300 | 250-300 Para obturadores a base de óxido de zinc eugenol | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
| | | 500 Para guttapercha | | | | |

Go-Two

| GO-TWO Longitud de la parte de trabajo: 16 mm y 21 mm | | | |
|---|------|-----------------|--------|
| ROTACIÓN CONTINUA | | | |
| Conicidad | ISO | Velocidad (RPM) | Torque |
| 4% | N°10 | 250 | 1,2 |
| | N°35 | 250 | 1,2 |
| | N°40 | 250 | 2 |
| 5% | N°15 | 250 | 1,2 |
| | N°30 | 250 | 1,2 |
| 6% | N°20 | 250 | 2 |
| | N°25 | 250 | 2 |
| | N°30 | 250 | 1,5 |
| | N°35 | 250 | 1,5 |
| | N°40 | 250 | 2 |
| 7% | N°25 | 250 | 2 |

Pretratamiento

| PRODUCTO | LIMAS | | | | Tipo de movimiento |
|-----------------------|-----------|---------|-----------------|--------|---|
| | Conicidad | ISO | Velocidad (RPM) | Torque | |
| GO-GLIDER | 2% | 16 | 250 | 2,5 |  |
| PREFILE | 2% | Surtido | 300 | 2 |  |
| | | 13 | | | |
| | | 16 | | | |
| | | 19 | | | |
| EASY-FILE FLEX GLIDER | 2% | 15 | 300 | 4 |  |

ENDO RADAR PLUS WOODPECKER

1.590,00€

899€

-43%

- Motor de endodoncia con localizador de ápice integrado.
- Movimiento en rotación continua y 3 modos de movimiento alterno a elegir.
- Permite hasta 11 programas integrados definidos por el usuario y hasta 30 modos predefinidos de las principales marcas y archivos.
- Ángulo de rotación preciso, reduce el riesgo de fractura del instrumento y permite una mayor eficiencia de preparación.
- Motor led inalámbrico.

PANTALLA LCD HD.
BOTONERA TÁCTIL MEJORADA.
BATERÍA EXTRA-LARGA
DURACIÓN.



3137439 Endo Radar Plus Blanco 1.590,00€ 899,00€


APEX LOCATOR CLINIX

-38%

564,00€

349€

- Permite una localización precisa y reproducible de los ápices durante el tratamiento endodóntico.
- Funciona eficazmente en cualquier condición de uso: conducto húmedo o seco.
- Las imágenes indican la trayectoria de la lima y el límite del ápice.
- Portalimas, ganchos labiales y sonda táctil esterilizables en autoclave a 134°C 18 min.
- Pantalla led LCD 4,5".
- Peso: 350 g.
- Dimensiones: 138 x 77 x 107 mm.

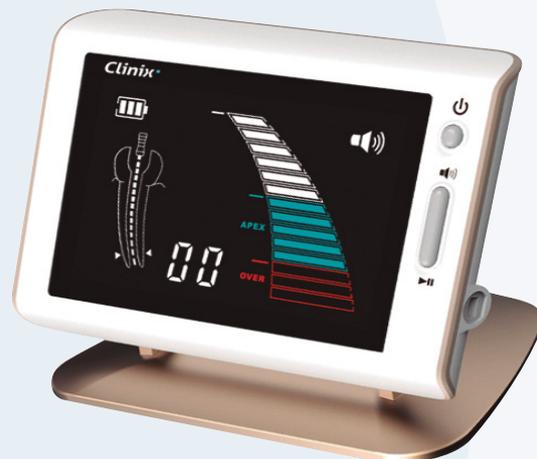

3107262 Ápex Locator 564,00€ 349,00€